

「医薬品の封の取扱い等について」に関する情報について

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて平成30年8月1日付 厚生労働省医薬・生活衛生局長通達（薬生発 0801 第1号）「医薬品の封の取扱い等について」の発出に基づき、弊社の医療用医薬品の封に関する情報をご案内申し上げます。


謹白

ブリスターパック製品

(例) クアトロバック® 皮下注シリンジ

未開封の確認方法

未開封の状態

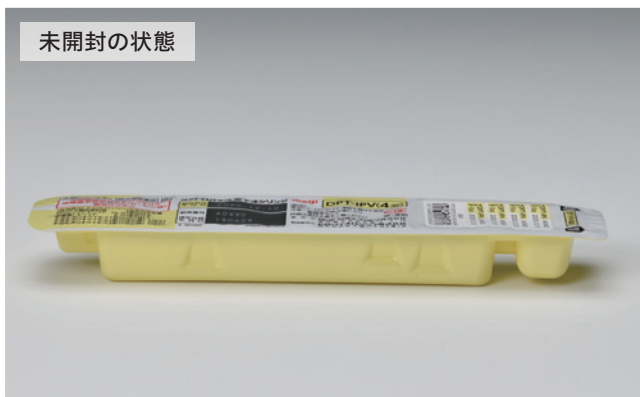

次の事項を確認してください

- ・ 圧着面が剥がれていない



適切な開封方法

① 開封方法




「開」のマーク部分から上下に開く

② 開封の状態



⚠ 以下の場合にはすでに開封されている可能性があります

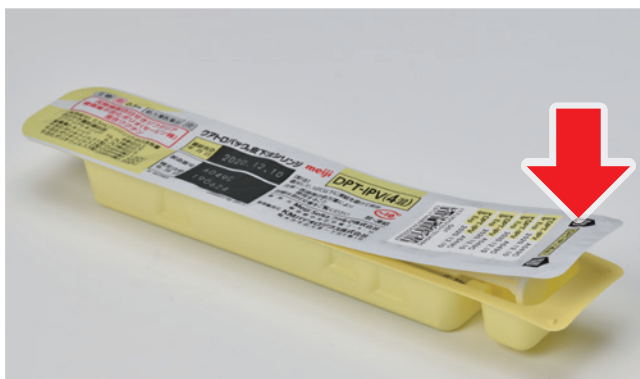

圧着面が剥がれている



封緘テープ製品

(例) コンファクト® F 注射用 250/500/1000

未開封の確認方法

未開封の状態



次の事項を確認してください

- ・ミシン目が切れていないこと
- ・封緘テープがしっかりと貼付けされていること
- ・ケース全体に不自然な破れがないこと

適切な開封方法

① 開封方法



② 開封の状態



開封口に指をあてミシン目に沿って開封する

⚠ 以下の場合にはすでに開封されている可能性があります


ミシン目が切れている



テープが切れている



底面の糊が剥がされている

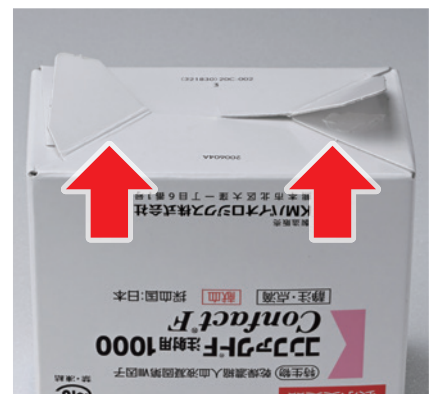

のり封緘（ミシン目）製品

（例）インフルエンザHAワクチン「KMB」

未開封の確認方法

未開封の状態



次の事項を確認してください

- ・ミシン目が切れていないこと
- ・ケース全体に不自然な破れがないこと

適切な開封方法

① 開封方法



開口 に指をあてミシン目に沿って開封する

② 開封の状態



⚠ 以下の場合にはすでに開封されている可能性があります

ミシン目が切れている



糊が剥がされている



のり封緘（ミシン目）製品

(例) ボルヒール®組織接着用

未開封の確認方法

未開封の状態



次の事項を確認してください

- ・ミシン目が切れていないこと
- ・ケース全体に不自然な破れがないこと

適切な開封方法

① 開封方法




押し開け口 に指をあてミシン目に沿って開封する

② 開封の状態



⚠ 以下の場合はずでに開封されている可能性があります

ミシン目が切れている

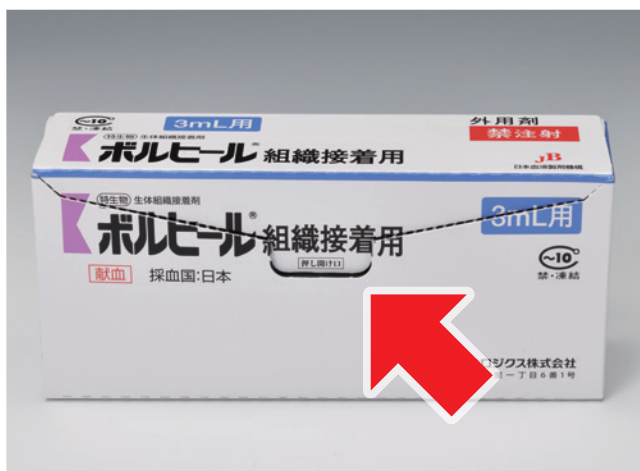

糊が剥がされている

